

**Procedura di affidamento mediante il ricorso a sistemi elettronici e telematici di  
negoziazione, per la fornitura di un'incubatrice neonatale da trasporto, completa di  
attrezzature biomediche di supporto, destinata all'utilizzo in ambulanza (CIG  
7952317B94)**




**PRIMO VERBALE DI SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE TECNICA PER  
LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PERVENUTE**

Id. n. 110076855 del 13.11.2019

Premesso che:

- con determinazione del Direttore del Dipartimento approvvigionamenti e affari economico finanziari n. 891|2019 di data 08/07/2019 è stata indetta la procedura di affidamento mediante il ricorso a sistemi elettronici e telematici di negoziazione, per la fornitura di un'incubatrice neonatale da trasporto, completa di attrezzature biomediche di supporto, destinata all'utilizzo in ambulanza;
- per l'affidamento della fornitura in oggetto è stata prevista un'aggiudicazione da determinare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa mediante la valutazione degli elementi indicati nella lettera di invito alla gara;
- in data 10.07.2019 è stata pubblicata su MePA la Rdo n. 2346588, stabilendo quale termine di presentazione delle offerte il giorno 06.08.2019, entro e non oltre le ore 09.00;
- è pervenuta inoltre la richiesta di proroga dei termini accolta a seguito di valutazione del RUP, stabilendo quale termine di presentazione delle offerte il giorno 22.08.2019, entro e non oltre le ore 09.00;
- in data 26.08.2019 si è tenuta la seduta pubblica per l'apertura dell'offerta telematica, nel corso della quale è stata verificata la regolarità della documentazione amministrativa e tecnica, come risulta da verbale agli atti: le ditte partecipanti risultano ammesse alla fase successiva della trattativa relativa alla valutazione dell'offerta tecnica;
- con determinazione n. 1256|2019 di data 26/09/2019 del Direttore del Dipartimento Approvvigionamenti e Affari Economico-Finanziari si è provveduto a nominare la Commissione tecnica incaricata della valutazione delle offerte nella seguente composizione:
  - dott. Riccardo Malossi – Dirigente Medico U.O. Neonatologia – Ospedale Santa Chiara Trento– PRESIDENTE;
  - coord. Sergio Bertoldi – Coordinatore Infermieristico U.O. Trentino Emergenza – COMPONENTE;
  - ing. Simona Anzivino – Collaboratore tecnico professionale presso il Servizio Ingegneria Clinica – COMPONENTE.

Tutto ciò premesso,

    
1

l'anno duemiladiciannove (2019) il giorno trenta (30) del mese di settembre alle ore quattordici e dieci minuti (14:10) presso la sala archivio della U.O. di Neonatologia dell'Ospedale S. Chiara di Trento, si è riunita la Commissione tecnica incaricata della valutazione delle offerte presentate dalle ditte partecipanti alla procedura di affidamento, mediante il ricorso a sistemi elettronici e telematici di negoziazione, per la fornitura di un'incubatrice neonatale da trasporto, completa di attrezzature biomediche di supporto, destinata all'utilizzo in ambulanza (CIG 7952317B94).

Alla seduta hanno preso parte:

- dott. Riccardo Malossi – Dirigente Medico U.O. Neonatologia – Ospedale Santa Chiara Trento– PRESIDENTE;
- coord. Sergio Bertoldi – Coordinatore Infermieristico U.O. Trentino Emergenza – COMPONENTE;
- ing. Simona Anzivino – Collaboratore tecnico professionale presso il Servizio Ingegneria Clinica – COMPONENTE.

Il Presidente della Commissione prende atto della regolare costituzione della stessa e ne assume la presidenza.

Il Presidente prende atto che la documentazione tecnica viene resa disponibile, in formato elettronico, alla Commissione Tecnica dalla Sig.ra Anna Sartori, funzionario del Servizio Acquisti e Gestione Contratti.

Il Presidente dispone che le funzioni del segretario verbalizzate vengano svolte dall'ing. Simona Anzivino, collaboratore tecnico professionale presso il Servizio Ingegneria Clinica.

Il Presidente in seduta riservata, apre i lavori della Commissione precisando che oggetto di valutazione saranno le offerte tecniche presentate dai concorrenti, di seguito indicati in ordine alfabetico:

Burke&Burke  
Waldner Technologie Medicali

Si procede innanzitutto all'esame degli atti di gara e in particolare della lettera d'invito, dei criteri di valutazione, del capitolato speciale d'appalto. Ciò prima di conoscere il contenuto delle offerte tecniche che saranno oggetto di valutazione.

Il Presidente comunica ai componenti della Commissione che a supporto della valutazione delle caratteristiche tecniche, la Commissione Giudicatrice potrà richiedere la visione e la prova dell'apparecchiatura (nella configurazione offerta) secondo i termini e le modalità stabiliti dalla Commissione Giudicatrice.

Il Presidente ricorda ai componenti della Commissione la segretezza delle operazioni di valutazione e l'importanza di effettuare valutazione oggettive, rimarcando il fatto che ogni proposta deve essere valutata come oggetto a se stante rispetto ai desiderata espressi nel capitolato speciale d'appalto e nella documentazione di gara.

Gli elementi di valutazione e sub valutazione previsti sono di seguito riportati:



N.	Criteri di valutazione	Punteggio assegnabile
A	Caratteristiche tecniche	P1: max 50 punti
B	Caratteristiche della gestione post vendita	P2: max 20 punti
	<b>Totale</b>	<b>70</b>

### A Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche dei device inclusi nel "sistema medicale" (funzionalità, facilità d'uso, accessoristica, durata autonomia,...)	Max 20 punti
Caratteristiche dei display (es: interfaccia utente chiara), facilità d'uso, intuitività dei comandi e caratteristiche degli allarmi acustici e visivi (es: buona visibilità degli indicatori di controllo)	Max 10 punti
Caratteristiche strutturali del "sistema medicale" (dimensioni d'ingombro, peso complessivo del sistema, portata massima del carrello auto caricante, ergonomia, sistemi di fissaggio, robustezza del carrello,...)	Max 5 punti
Facilità di manovra a terra, distribuzione dei pesi, regolazione dell'altezza del carrello, facilità di carico e scarico e stabilità durante il trasporto in ambulanza	Max 10 punti
Facile accesso ai vari dispositivi medici inclusi nel "sistema medicale" offerto e facilità di accesso al paziente	Max 5 punti
<b>TOTALE</b>	<b>MAX 50 PUNTI</b>

### B Caratteristiche della gestione post vendita

Formazione del personale (contenuti, impegno orario, centri di riferimento,..) e protocolli per la manutenzione preventiva e operatore	Max 10 punti
Contenuti dei servizi di assistenza tecnica (centro di assistenza più vicino, tempi di intervento e riparazione, struttura organizzativa e logistica del servizio di assistenza tecnica,..)	Max 10 punti
<b>TOTALE</b>	<b>MAX 20 PUNTI</b>

L'assegnazione dei punteggi agli elementi e sub-elementi avverrà con la seguente modalità: ciascun componente della Commissione giudicatrice valuta ogni offerta in relazione ad ogni singolo sub-criterio, assegnando ad essa un coefficiente variabile tra 0 e 1, secondo la seguente griglia:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
eccellente	1,00
ottimo	0,90
distinto	0,80
molto buono	0,70
buono	0,60
discreto	0,50
più che sufficiente	0,40
sufficiente	0,30
non del tutto sufficiente	0,20





insufficiente	0,10
non valutabile o assente	0,00

Dopo l'attribuzione dei coefficienti a ciascun sub-criterio di valutazione da parte dei singoli commissari, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti (coefficienti provvisori).

Si procede quindi all'assegnazione dei punteggi, per ogni singolo sub-criterio di valutazione, moltiplicando i coefficienti definitivi ottenuti per il punteggio massimo assegnabile al subcriterio considerato.

Il punteggio ai singoli criteri di valutazione (A B), di cui alla tabella sopra riportata, viene attribuito attraverso la somma dei punteggi attribuiti a ciascun sub-criterio.

Il punteggio assegnato all'offerta tecnica viene calcolato mediante la somma dei punteggi attribuiti ai criteri di valutazione.

Le operazioni della Commissione Giudicatrice sono verbalizzate in apposito verbale nel quale vengono precisate anche le motivazioni del punteggio assegnato e delle eventuali inidoneità comportanti l'esclusione dalla gara.

Esaurita la valutazione degli atti di gara e riprese le modalità dell'espletamento delle attività di competenza, la Commissione può procedere all'esame della documentazione tecnica ricevuta.

Il Presidente dispone di organizzare il lavoro della Commissione Tecnica in due fasi distinte:

1. Valutazione della documentazione fornita da ciascun concorrente per verificarne la completezza e la rispondenza ai requisiti tecnici;
2. Attribuzione dei punteggi delle offerte tecniche.

La Commissione procede quindi con la valutazione della documentazione fornita dai concorrenti per verificarne la completezza rispetto ai documenti richiesti nella Lettera d'Invito, seguendo l'ordine alfabetico.

La Commissione avvia la lettura dell'offerta tecnica del concorrente Burke&Burke.


Durante la lettura dei documenti tecnici ricevuti è emersa l'esigenza di richiedere i seguenti chiarimenti alla ditta concorrente:

Burke&Burke

*“Specificare se tutti i componenti della fornitura sono certificati per l'utilizzo in ambulanza (conformità alla direttiva EN 1789)”*

*“Specificare se in fornitura sono incluse n. 2 bombole di ossigeno e le misure degli spazi disponibili per il loro alloggiamento”.*

La Commissione avvia la lettura dell'offerta tecnica del concorrente Waldner Technologie Medicali.

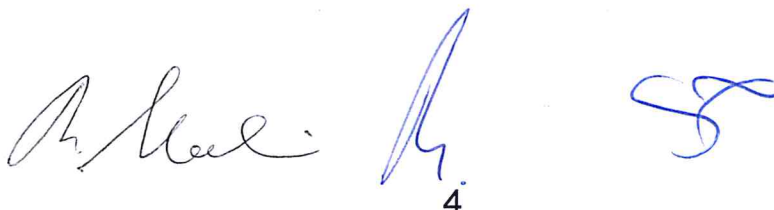

4

Durante la lettura dei documenti tecnici ricevuti è emersa l'esigenza di richiedere i seguenti chiarimenti alla ditta concorrente:

Waldner Tecnologie Medicali

*“Specificare se tutti i componenti della fornitura sono certificati per l'utilizzo in ambulanza (conformità alla direttiva EN 1789)”*

*“In riferimento al punto 7 della documentazione tecnica, le dichiarazioni di conformità dell'incubatrice vanno corredate dalle dichiarazioni di conformità degli altri dispositivi medici inclusi nel “sistema medicale””*

*“In riferimento al punto 8 della documentazione tecnica, le Certificazioni CE di conformità alla direttiva europea 93/42/CEE e ss.mm.ii ed eventuali certificazioni del Sistema di gestione della Qualità del fabbricante (ISO 13485) e fornitore (ISO 9001) dell'incubatrice vanno corredate da quelle degli altri dispositivi medici inclusi nel “sistema medicale””*

*“In riferimento al punto 9 della documentazione tecnica l'indicazione del numero di iscrizione alla Banca Dati dei Dispositivi Medici del Ministero della Salute dell'incubatrice vanno corredate da quelle degli altri dispositivi medici inclusi nel “sistema medicale””*

*“Specificare le misure degli spazi disponibili per l'alloggiamento delle bombole”*

*“In riferimento al punto 12 della documentazione tecnica, specificare mediante test report la resistenza ad accelerazioni/decelerazioni 10 g in direzione longitudinale, trasversale e verticale”.*


Completata la lettura delle offerte tecniche, il Presidente dispone la trasmissione delle suddette richieste di chiarimento ai funzionari del Servizio Acquisti e Gestione Contratti, affinché inviino tali richieste alla ditta concorrente.

Alle ore 17:35 il Presidente del seggio di gara dichiara chiusa la prima seduta, mentre la sottoscrizione del relativo verbale avverrà all'inizio della seduta successiva, in data da definirsi.

Letto, firmato e sottoscritto,


Trento, 29 ottobre 2019.

Il Presidente: dott. Riccardo Malossi



---

Il Componente: dott. Sergio Bertoldi



---

Il Componente con funzioni anche di segretario verbalizzante: ing. Simona Anzivino



---

