

**Procedura di affidamento mediante il ricorso a sistemi elettronici e telematici di  
negoziazione, per la fornitura di un'incubatrice neonatale da trasporto, completa di  
attrezzature biomediche di supporto, destinata all'utilizzo in ambulanza (CIG  
7952317B94)**

**TERZO VERBALE DI SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE TECNICA PER  
LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PERVENUTE**

Id. n. 110597027 del 26.11.2019

L'anno duemiladiciannove (2019) il giorno sei (6) del mese di novembre alle ore otto (8) e cinquantacinque (55) presso la sala archivio della U.O. di Neonatologia dell'Ospedale S. Chiara di Trento, si è riunita la Commissione tecnica incaricata della valutazione delle offerte presentate dalle ditte partecipanti alla procedura di affidamento, mediante il ricorso a sistemi elettronici e telematici di negoziazione, per la fornitura di un'incubatrice neonatale da trasporto, completa di attrezzature biomediche di supporto, destinata all'utilizzo in ambulanza (CIG 7952317B94).

Alla seduta hanno preso parte:


- dott. Riccardo Malossi – Dirigente Medico U.O. Neonatologia – Ospedale Santa Chiara Trento – PRESIDENTE;
- coord. Sergio Bertoldi – Coordinatore Infermieristico U.O. Trentino Emergenza – COMPONENTE;
- ing. Simona Anzivino – Collaboratore tecnico professionale presso il Servizio Ingegneria Clinica – COMPONENTE.

Il Presidente della Commissione prende atto della regolare costituzione della stessa e ne assume la presidenza.

Il Presidente procede alla lettura del verbale n.2 della seduta del 29 Ottobre 2019, che viene condiviso e sottoscritto dai componenti della Commissione Tecnica.

Il Presidente da quindi inizio ai lavori e prende atto che la documentazione tecnica viene resa disponibile, in formato elettronico, alla Commissione Tecnica dal segretario verbalizzante ing. Simona Anzivino - Collaboratore tecnico professionale presso il Servizio Ingegneria Clinica.

La Commissione avvia la lettura delle risposte ai chiarimenti richiesti durante la seconda seduta alla ditta concorrente Burke&Burke e pervenuti entro la data odierna e, sulla base dell'analisi effettuata durante la scorsa seduta, reputa opportuno richiedere un'ulteriore chiarimento alla ditta suddetta:

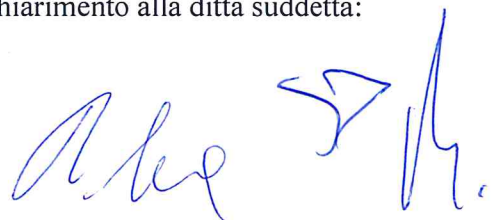

*In riferimento alla caratteristica tecnica A.14 specificare le funzioni dell'incubatrice in caso di alimentazione a bassa tensione (durante il trasporto in ambulanza).*

Il Presidente dispone di trasmettere la suddetta richiesta di chiarimento ai funzionari del Servizio Acquisti e Gestione Contratti, affinché inviino tale richiesta alla ditta concorrente.

La Commissione procede quindi alla lettura dei chiarimenti presentati dalla ditta concorrente Waldner Technologie Medicali e pervenuti entro la data odierna. Dalle risposte ottenute, si evince che la documentazione tecnica fornita risulta essere incompleta rispetto a quanto richiesto dalla lettera d'invito ma per verificare se essa è comunque sufficiente ed idonea ad accertare la sussistenza dei requisiti minimi obbligatori indicati nel capitolato tecnico-amministrativo la Commissione decide di procedere all'esame di questi ultimi.

La Commissione procede dunque all'esame della documentazione tecnica presentata dalla ditta concorrente Waldner Technologie Medicali per verificarne la rispondenza ai requisiti tecnici.


Dall'esame della documentazione tecnica sono emerse le seguenti non congruità rispetto ai requisiti tecnici riportati sul capitolato tecnico-amministrativo:

- in riferimento alle caratteristiche minime che l'incubatrice neonatale da trasporto deve possedere (punto A del capitolato tecnico-amministrativo), il requisito tecnico "A.13. display di controllo frontale con visualizzazione almeno dei seguenti parametri: stato batteria, allarmi, temperatura aria, temperatura paziente, saturimetria e frequenza cardiaca" non risulta essere rispettato. L'incubatrice proposta in offerta è dotata di un display che non consente la visualizzazione dei parametri saturimetria e frequenza cardiaca;
- sulla base della documentazione ricevuta sia in sede di gara che a seguito di apposito chiarimento inviato alla ditta, risulta impossibile accertare, per tutti i componenti del sistema complessivo, la sussistenza del requisito tecnico "tutti i componenti della fornitura devono essere certificati come Dispositivi Medici ai sensi delle direttive europee 93/42 e ss.mm.ii. ed esser certificati per l'utilizzo in ambulanza (EN 1789)" con particolare riferimento alla prima parte "tutti i componenti della fornitura devono essere certificati come Dispositivi Medici ai sensi delle direttive europee 93/42 e ss.mm.ii."

La Commissione prende dunque atto, dall'esame della documentazione tecnica, che l'offerta presentata dalla suddetta ditta non risulta essere conforme ai requisiti tecnici minimi previsti dal capitolato.

La prova pratica verrà comunque espletata come precedentemente programmato secondo le scadenze previste nella documentazione di gara.


Alle ore 12:08 il Presidente del seggio di gara dichiara chiusa la terza seduta, mentre la sottoscrizione del relativo verbale avverrà all'inizio della seduta successiva che si terrà in data da definirsi.

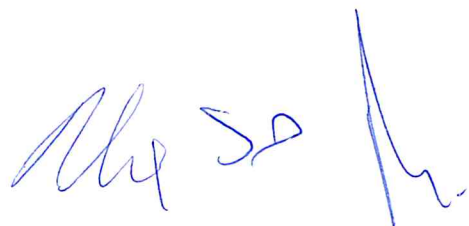

Letto, firmato e sottoscritto,

Trento, 19 novembre 2019.


Il Presidente: dott. Riccardo Malossi

  
\_\_\_\_\_

Il Componente: coord. Sergio Bertoldi

  
\_\_\_\_\_

Il Componente con funzioni anche di segretario verbalizzante: ing. Simona Anzivino

  
\_\_\_\_\_

